

高精度线性电源

IPC 系列使用说明书

Precision DC Source
IPC Series User's Manual

IPC5-12

IPC10-1

IPC12-5

IPC20-3

IPC48-1.25

IPC100-0.6

IPC300-0.2

IPC6-10


IPC10-6

IPC15-5

IPC30-2

IPC60-1

IPC200-0.3

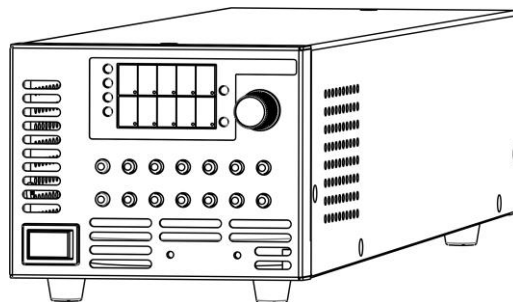

注意事项

感谢您平日对英特罗克（以下简称为「本公司」）产品的厚爱。

请在操作本公司产品前认真阅读该使用说明书，阅读完之后请放在身边以便查阅。搬运产品的同时请不要忘记使用说明书。

如果您发现本使用说明书有任何不正确的排版或者页面丢失，您可以要求替换。如果本使用说明书被弄脏或者弄丢，请联系本公司索要免费的新副本，索要副本时请提供仪器机身上的产品 ID 号。本公司的产品均在 ISO 9001 质量管理体系内进行设计、生产、检验及销售。本产品出厂时，都有唯一 ID 号与之对应。ID 号均可在产品包装箱、产品校准（检验）证书和产品机身上获得。

本公司相关人员已经仔细查阅过该使用说明书，但是如果您有任何疑问或者发现任何错误和遗漏，请联系本公司或登录 <http://www.interlock-china.com>。

没有本公司授权和允许，禁止对使用说明书的全部或部分内容进行重新生产或印刷。

由于产品改良，在使用说明书内容上进行变更而未能事先告知，敬请谅解。

质量保证

IPC 系列产品自出厂之日起质保两年。质保范围的例外：故障原因属于下列情况的，不提供质保：

- 未按本使用说明书的方法进行使用的
- 人为操作不当造成的损坏
- 上述情况以外，其它不属于本公司产品的原因，包括自然灾害等不可抗拒因素

务必确保您享受的质保处于有效状态：

请勿揭掉仪器的 ID 号标签

如果揭掉了仪器的 ID 号标签，并且提供不了有效的仪器 ID 号，质保将无效。

阅读使用手册

在使用仪器之前，请仔细阅读使用手册。

禁止外界物质进入仪器内部

禁止打开仪器外壳。触摸仪器内部元件可能会损坏元件。

务必小心，不要让流体、易燃物或金属进入仪器壳体内部。在仪器内部有外界物质的情况下启动仪器，有可能会损坏仪器并引起火灾。

电磁场

不要将仪器置于强电磁场的环境中工作。远离静电场放电。

腐蚀性气体

不要将仪器置于腐蚀性气体环境中工作，这将有可能引起爆炸和火灾。

运输

使用仪器原始包装进行运输，请勿改变包装。

清洁

如无必要，请不要清洁仪器内部。清洁外部，请用柔软、无腐蚀性的清洁用品。

安全标识

为了安全的使用和维护该产品，以下警示标识贯穿整个手册并也出现在产品上。请理解这些标识的含义并按照它的提示操作。

| 标识形状 | 名称 | 解释说明 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|
|  | 危险高压 | 表示这个标记出现的地方有高压。触碰这个地方可能导致致命电击。如果必须进行接触，请在触碰之前确保这里没有电压输出。 |
| DANGER | 危险 | 表示如果不注意会有导致死亡或者严重伤害的非常紧急的危险。 |
| WARNING | 警告 | 表示如果不注意会有导致死亡和严重伤害的潜在的危险。 |
| CAUTION | 注意 | 表示如果不注意会有导致对仪器或者其他物体造成损坏的潜在的危险。 |
|  | 强调 | 一般加在 DANGER, WARNING, CAUTION 之前表示强调。 |
|  | 保护接地 | 表示表在发生故障时防止电击的与外保护导体相连接的端子，或与保护接地电极相连接的端子。 |
|  或  | 机壳/机架接地 | 表示连接机壳、机架的端子。 |

安全规则

请务必遵守以下安全规则以免电击伤害、火灾、危险事故及不可预知灾害发生。请时刻谨记这些安全规则并严格执行。

| 名称 | 规则 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 操作人员 | <ul style="list-style-type: none"> ● 仪器的操作者必须是理解使用手册内容的训练有素的人员。 ● 未经培训的操作者请在懂得电气知识并经过培训的工作人员的监管下使用该仪器。 ● 本仪器不是为了家庭消费用途设计，不能当家用电器设备使用。 |
| 电力输入 | <ul style="list-style-type: none"> ● 使用本仪器时请确保输入规定的电压。 ● 使用时，请使用附赠的交流输入电缆。请注意，附赠的电缆不能用于能在不同输入电压切换条件下工作的产品，也不能用于输入电压在 100V 和 220V 间无切换键的产品。如遇这种情况，请另外选择合适的电缆。 |
| 保险丝 | 仪器的内部有保险丝，保险丝可以保护电源。更换时，请选择与原保险丝同样的外形尺寸和参数。 |
| 外罩 | 由于仪器内部的组成部件可能对人体造成危险，请不要擅自打开仪器外罩。 |
| 安装 | <ul style="list-style-type: none"> ● 在安装仪器的时候请遵守使用手册中所描述的安装事项。 ● 为了避免电击，请将仪器的保护接地端子与电气大地（安全大地）连接。 ● 在将交流输入电缆连接到插线板时，请由经过培训并有资质的电气工程师完成或者在他的指导下完成。 |
| 移动仪器 | <ul style="list-style-type: none"> ● 在移动仪器之前请关断电源开关并且断开所有连接电缆。 |
| 操作 | <ul style="list-style-type: none"> ● 检查交流输入电压和保险丝的参数是否合格，并且检查交流输入电缆表面有无异常。在检查之前请确保拔出电源插头和停止使用电源。 |

INTERLOCK TECHNOLOGIES

| | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none">● 如果检查到任何本仪器的异常现象或者错误，立即停止使用。拔掉交流输入插头或者断开交流输入电缆与配电板的连接。在彻底修理好之前请确保不要使用电源。● 对于输出电缆或者负载电缆，请选择有更大电流承载能力的电缆。● 不要擅自拆卸或者修理该仪器。如果必须要修理，请联系厂家或者代理。 |
| 维护和检查 | <ul style="list-style-type: none">● 为了避免电击，在完成维护和检查之前请一定要确保拔掉交流输入插头和停止使用电源。● 在维护和检查该仪器时不能打开外罩。● 为了保持仪器的安全使用，请定期对仪器进行维护，检查，清理和校准。 |
| 服务 | 更多服务请联系厂家或者代理。如果产品必须维修或者校准，请联系厂家或代理。 |



目 录

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 第一章 概 述 | 8 |
| 第二章 面板名称和功能 | 10 |
| 2.1 前面板..... | 11 |
| 2.2 后面板..... | 16 |
| 第三章 准备工作 | 18 |
| 3.1 连接交流输入电缆..... | 19 |
| 3.2 连接电源输出到负载的输出电缆..... | 19 |
| 3.3 电压补偿..... | 20 |
| 3.3.1 本地电压补偿模式..... | 21 |
| 3.3.2 远端电压补偿模式..... | 21 |
| 3.4 连接负载时的注意事项..... | 25 |
| 3.4.1 如何连接多个负载..... | 25 |
| 3.4.2 感性负载的注意事项..... | 26 |
| 3.4.3 负载有类似电池的储能作用..... | 26 |
| 第四章 基本操作 | 28 |
| 4.1 基本使用流程..... | 29 |
| 4.2 让电源恒流输出..... | 30 |
| 4.3 让电源恒压输出..... | 31 |
| 4.4 OVP 的设定..... | 32 |
| 4.5 OCP 的设定..... | 32 |
| 4.6 报警的种类和报警状态的解除..... | 33 |
| 第五章 远程控制 | 34 |
| 5.1 远程控制接口..... | 35 |
| 5.2 RS232 接口使用流程..... | 37 |
| 5.3 RS485 接口使用流程..... | 38 |
| 5.4 RS232/RS485 接口程控使用说明..... | 40 |
| 5.4.1 指令说明..... | 40 |
| 5.4.2 IPC 系列电源 RS485 接口指令系统..... | 41 |
| 5.4.3 IPC 系列电源 RS232 接口指令系统..... | 46 |
| 5.5 电压和电流的程控校准..... | 52 |
| 5.5.1 需要的测试设备..... | 52 |

| | |
|---------------------|-----------|
| 5.5.2 环境..... | 52 |
| 5.5.3 校准步骤..... | 52 |
| 第六章 参数..... | 57 |
| 6.1 IPC 系列性能参数..... | 58 |
| 6.2 外观和尺寸..... | 61 |

1

第一章 概述

主要介绍本使用说明书适用范围，本仪器性能特点和功能特点。

第一章 概述

本手册适用于型号为 IPC 系列的产品。包括：

【IPC5-12】 【IPC6-10】 【IPC10-1】 【IPC10-6】
【IPC12-5】 【IPC15-5】 【IPC20-3】 【IPC30-2】
【IPC48-1.25】 【IPC60-1】 【IPC100-0.6】 【IPC200-0.3】
【IPC300-0.2】

IPC 系列电源是一种利用精密线性稳压稳流技术实现了极低噪声稳定输出的可编程线性电源。用户可以作为台面仪器使用，也可以在高度为 2U 的 19 英寸标准机架上安装 4 台 IPC 电源。IPC 系列电源最大功率可达 60W，输出电压最高达 300V，输出电流最大达 12A。用户可通过电源前面板方便地对电源进行控制（调节输出电压、电流值，4 组预设电压、电流值并且可在各组值之间切换输出，设置 OVP、OCP 限定值以及其他系统参数）。电源采用高亮度的 LED 显示输出电压、电流和功率值以及电源状态。电源后面板标配 RS232 和 RS485 通讯接口，方便用户组成需要的自动测试系统。

IPC 系列电源可广泛应用于实验室测试、生产线产品检测等。

产品特点

- 功率 60W 的高精度线性电源
- 非常小的纹波，输出纯净
- 可切换电源输出的正、负极性
- 预存 4 组电压、电流值，并且可切换输出
- 电源设置参数具有掉电存储功能，恒流恒压模式自动切换
- 远端补偿功能，能够补偿连接到负载的线路上的电压降
- 标配 RS232 和 RS485 程控接口，程控指令兼容 SCPI 指令集
- 智能风扇控制，可降低噪音和延长风扇寿命
- 完善的保护功能，包括 OVP、OCP、OTP 故障保护
- 故障监测功能，方便故障分析和排查



第二章 面板名称和功能

主要介绍前后面板上开关、显示、接口和其他部件的名称、功能。阅读本章以了解面板上标志的细节。

第二章 面板名称和功能

2.1 前面板

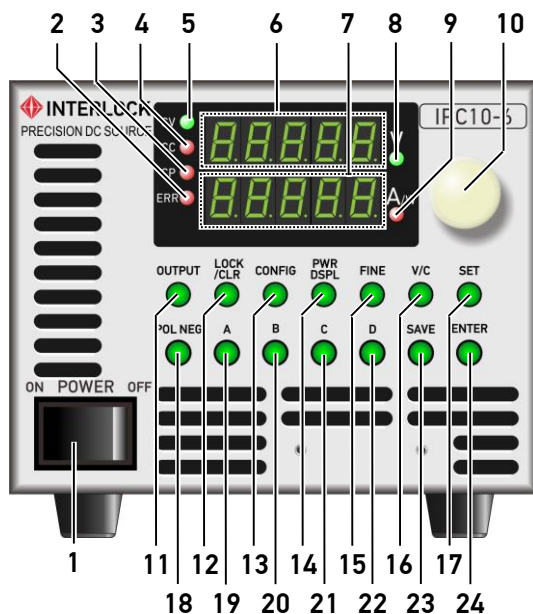


图 2-1 IPC 系列前面板

【1】POWER 开关

电源的交流输入供电开关，拨到 ON 方向为开，拨到 OFF 方向为关。

【2】ERR 指示灯

电源错误状态指示灯。当电源工作于非正常状态时，ERR 指示灯红灯亮起，且面板显示所对应错误状态的数值。

【3】CP 指示灯

此功能未使用。

【4】CC 指示灯

电源输出处于恒流状态时，CC 灯亮。

【5】CV 指示灯

电源输出处于恒压状态时，CV 灯亮。

【6】电压显示

当【POWER】开关打开或者【OUTPUT】键按下时，显示电压输出值；

当【SET】键按下时显示电压预设值；

当【CONFIG】键被按下时，显示系统参数设置项；

当【PWR DSPL】键被按下时，显示字符“Pr”；

当电源处于非正常工作状态的时候，显示字符“Err”。

【7】电流显示

当【POWER】开关打开或者【OUTPUT】键按下时，显示电流输出值；

当【SET】键按下时显示电流预设值；

当【CONFIG】键按下时，显示系统参数设置项的具体数值。

当【PWR DSPL】键被按下时，显示电源的输出功率；

当电源处于非正常工作状态的时候，显示错误状态具体数值。

【8】V 指示灯

电压选中指示灯，配合【SET】和【V/C】按键进行指示。当按下【SET】按键，用【V/C】按键进行电压/电流选中切换时，V 指示灯绿灯亮起表示当前选中电压，用户可以通过旋钮调节电压的大小。

【9】A 指示灯

电流选中指示灯，配合【SET】和【V/C】按键进行指示。当按下【SET】按键，用【V/C】按键进行电压/电流选中切换时，A 指示灯红灯亮起表示当前选中电流，用户可以通过旋钮调节电流的大小。

【10】调节旋钮

配合【SET】和【V/C】按键可以调节电压或者电流的大小；

配合【CONFIG】按键可以调节系统参数设置项的具体数值。

【11】 OUTPUT 按键

直流输出控制开关。按一下为开，且按键绿灯亮起，再按一下为关，且按键绿灯熄灭。当输出关断的时候，电源的输出为高阻。

【12】 LOCK/CLR 按键

面板锁定和报警状态清除的复用按键。

按下【LOCK/CLR】按键，且按键绿灯亮起，电源进入锁定状态，面板上除了【OUTPUT】按键外，其它按键和旋钮都不会响应外部控制。再按一下解除锁定状态，且按键绿灯熄灭。

当电源处于非正常工作状态时，ERR 指示灯红灯亮起，【LOCK/CLR】按键绿灯亮起，电源输出会自动切断。在不关电源【POWER】开关的情况下，用户需要按一次【LOCK/CLR】按键，清除错误状态，并且根据面板上错误状态提示，找到错误状态的原因并解决，然后才可以再次正常使用电源。

【13】 CONFIG 按键

系统参数设置按键。按一下此按键进入系统参数设置界面，且按键绿灯亮起。第一排数码管显示设置的参数名，第二排数码管显示具体设置值，用户可以通过【ENTER】按键进入此选项，然后通过右侧的旋钮进行参数值的改变。完成后，再按一下【ENTER】按键，系统退回参数名选择，然后通过右侧的旋钮进行改变。完成所有参数设置后，按一下【CONFIG】按键，按键绿灯熄灭，系统退出参数设置界面。系统参数设置参数依次如下所示：

OVP 电源过压保护设置值。电源电压输出值如果超过这个设置值，电源输出被切断，前面板 ERR 红灯亮起。需要人工按一下【LOCK/CLR】按键进行报警状态清除，并解决电源的故障，电源才能重新进行输出。

OCP 电源过流保护设置值。电源电流输出值如果超过这个设置值，电源输出被切断，前面板 ERR 红灯亮起。需要人工按一下【LOCK/CLR】按键进行错误状态清除，并解决电源的故障，电源才能重新进行输出。

rECL 用户在“A、B、C、D”四种电压电流预设值切换的时候，提供了两种电源输出状态的选择。有“0”和“1”两种状态，通过旋钮进行选择。

“0”表示用户切换“A、B、C、D”时，电源 OUTPUT 会切断；

“1”表示用户切换“A、B、C、D”时，电源 OUTPUT 一直打开。

rtSn 电压补偿功能设置。用户可以设置此参数项来选择是本地电压补偿还是远端电压补偿，有“0”和“1”两种状态，通过旋钮进行选择。

“0”表示本地电压补偿，电压补偿点在电源内部；

“1”表示远端电压补偿，电压补偿点通过补偿线连接到需要补偿的位置。

bAud 电源可编程控制接口 RS232 和 RS485 的波特率设置值。有四个值可供选择，通过旋钮进行数值切换。可选值如下所示：

- “24” 表示接口 RS232 和 RS485 的波特率设置值为 2400；
- “48” 表示接口 RS232 和 RS485 的波特率设置值为 4800；
- “96” 表示接口 RS232 和 RS485 的波特率设置值为 9600；
- “192” 表示接口 RS232 和 RS485 的波特率设置值为 19200。
- “384” 表示接口 RS232 和 RS485 的波特率设置值为 38400。
- “560” 表示接口 RS232 和 RS485 的波特率设置值为 56000。

Addr 电源可编程控制接口 RS485 的地址设置值。地址值从 1 到 254，用户可以通过旋钮进行设置。

【14】PWR DSPL 按键

功率显示按键。按一下【PWR DSPL】按键，且按键绿灯亮起，绿色 LED 数码管显示电源输出的功率值。再按一下关闭功率显示功能，且按键绿灯熄灭。

【15】FINE 按键

精调。按一下【FINE】按键开启精调功能，且按键绿灯亮起，再按一下关闭精调功能，且按键绿灯熄灭。在调节电压和电流数值的时候，电源系统默认显示位从左往右数第二位进行调节，在开启精调功能的时候，调节位变为从左往右数第一位。

【16】V/C 按键

在用户选择设置电压值和电流值之间进行切换。选中的焦点用数码管右方的绿色 LED 灯指示。选中电压时，绿色 LED 灯亮起。选中电流时，红色 LED 灯亮起。

【17】SET 按键

用来设置输出的电压或者电流的数值。按下【SET】按键的时候，按键绿灯亮起，调节旋钮来设置预设电压或者电流值。再按一下【SET】按键，按键绿灯熄灭，关闭设置值显示，这时候数码管显示电压电流的实际输出值。

【18】POL NEG 按键

用来切换电源输出的正负极性。按下【POL NEG】按键的时候，按键绿灯亮起，电源输出的正负极性切换。再按一下【POL NEG】按键，按键绿灯熄灭，电源输出极性还原。用户在切换极性前，必须确认负载没有电流会回流进入电源，以免造成电源损坏。

【19-22】A、B、C、D 按键

电压值和电流值的存储和调用按键。

存储。用户可以与【SAVE】按键配合预设四组值，分别存储在【A】～【D】四个按键中。用户先设置好电压值和电流值，然后按一下【SAVE】按键，按键绿灯亮起，然后用户选择【A】～【D】中的一个按键按一下，对应按键的绿灯亮起，再按一下【SAVE】按键，按键灯熄灭。数据就被存储到了按键中。

调用。用户可以直接按下【A】～【D】按键，来选出前面存储好的预设值。

【23】SAVE 按键

用来存储用户预设的电压和电流的数值。配合【A】～【D】四个按键使用。

【24】ENTER 按键

用来进入系统参数具体设置数值。配合【CONFIG】按键使用。

2.2 后面板

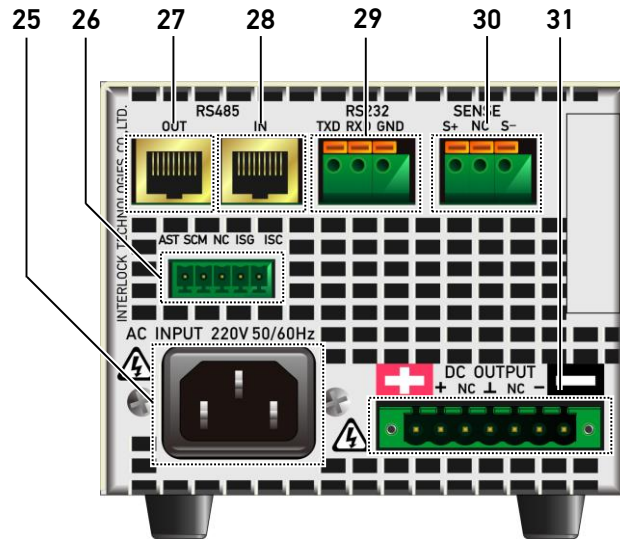


图 2-2 IPC 系列后面板

【25】交流输入接口

给电源供电的交流输入接口。交流输入 220 VAC \pm 10%，50/60 Hz。

【26】外部触点控制接口 J5

用户通过报警触点监视电源的报警状态。用户通过关断触点对电源输出状态进行控制。

AST 和 SCM 是报警触点（闭合对应报警，光耦输出）。

NC 是空位。

ISG 和 ISC 是 OUTPUT 关断触点（闭合对应允许 OUTPUT ON）。

【27】RS485 控制接口 J1

与上位机（电脑，PLC 或者单片机等）相对应的 RS485 接口连接，实现数字信号的远程控制。RS485 接口的波特率和地址可以由前面板和上位机程序进行设置。详见第五章。

【28】RS485 控制接口 J2

功能与 J1 完全相同，方便多台电源的 RS485 接口组网时使用。

【29】RS232 控制接口 J3

与上位机（电脑，PLC 或者单片机等）相对应的 RS232 接口连接，实现数字信号的远程控制。RS232 接口的波特率可以由前面板和上位机程序进行设置。详见第五章。

【30】电压远端补偿接口 J4

当负载与电源相距较远，且输出电线的线损压降不能忽略的时候，可以用使用电压远端补偿功能实现一定压降的弥补，详见第 3.3 节。

【31】直流输出接口

电源的直流输出与负载的连接口。输出接口为 Phoenix 的连接器的。

3

第三章 准备工作

主要介绍在使用本电源前，操作人员必须需要理解的一些知识。

第三章 准备工作

3.1 连接交流输入电缆

为了操作人员使用方便，IPC 系列电源在出厂时已经配好了交流输入电缆，操作人员只需要将插头插入电源后面板的相应插座并使其紧密连接。



注意！

确保配电板有足够的电流容量。

3.2 连接电源输出到负载的输出电缆

电缆的横截面积和允许通过的电流值如下：

| 线径 AWG | 最小横截面积 mm ² | 允许通过电流 A (30°C) | INTERLOCK 建议 通过电流值 A |
|-----------|---------------------------|--------------------|-------------------------|
| 16 | 1.25 | 19 | |
| 14 | 2 | 27 | 10 |
| 12 | 3.5 | 37 | |
| 10 | 5.5 | 49 | 20 |
| 8 | 8 | 61 | 30 |
| 6 | 14 | 88 | 50 |
| 4 | 22 | 115 | 80 |
| 2 | 30 | 139 | |

连接负载电缆的步骤

1. 根据负载最大电流选择合适的电缆和长度。
2. 操作人员可以取出随电源配备的绿色输出连接器, 将选好的输出电缆一端的绝缘层剥掉合适的长度, 将裸露的铜芯插入绿色输出连接器对应插口并用螺钉固定紧固。然后将连接器插入电源后面板对应的输出接口。严禁在电源输出打开的情况下, 拔插电源输出连接器。
3. 将输出电缆的另外一端连接到负载, 确保连接紧固。



注意!


在连接负载前请确认电源前面板的【POWER】开关和【OUTPUT】按键处于关闭状态, 否则可能发生电击。

3.3 电压补偿

IPC 系列电源在出厂的时候, 电压补偿端子已经牢固的安装在了后面板上, 并且采用的是本地电压补偿模式。用户在使用电源前, 请务必检查补偿电压端子是否完好。如果使用过程中有丢失, 请及时联系我们。

电压补偿端子的连线必须牢固, 如果出现松动, 会造成负载端的电压不稳定, 有可能过高的电压会加载到负载上。如果用户设置了 OVP 的保护功能, 有可能 OVP 会被触发造成输出关闭。

当用户使用完毕远端电压补偿的功能后, 请一定要把补偿端子还原成本地电压补偿的模式。



电压补偿端子接口 J4

图 3-1 电压补偿端子

3.3.1 本地电压补偿模式

IPC 系列电源在出厂的时候就在“CONFIG”中设置为本地电压补偿模式，“rtSn”设置为 0。在本地电压补偿模式下，电压补偿点为电压后面板上的直流输出连接器。采用这种方式的时候，对于电源直流输出接口到负载之间连接电线上的电压损耗是无法进行补偿的，所以这种模式只适用于负载电流很小，或者用户不用考虑线损的情况下。

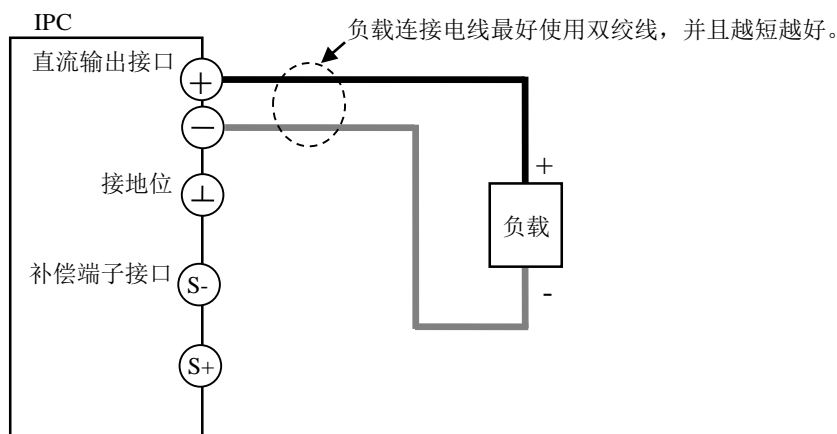


图 3-2 本地电压补偿模式

3.3.2 远端电压补偿模式

远端补偿功能主要是用来补偿电源输出接口到负载端连线上的压降，以便在负载端有恒定的电压。该功能大约能补偿的线上压降见“远端补偿功能最大补偿压降范围”。请选择有足够电流承载力的电缆，以便线上压降不会超过能够补偿的压降。

用户需要在“CONFIG”中将“rtSn”设置为 1。

在使用远端电压补偿功能的时候，需要在负载端的电压探测点连接一个电解电容。



警告！

可能产生电击，可能导致伤害甚至死亡。严禁在电源开关开启的时候连接电源补偿探测线。

始终关闭【POWER】开关和【OUTPUT】按键。

1. 关断 POWER 开关
2. 如图 3-3，用电线连接电压补偿接口的 S+和 S-引脚到负载的正极和负极

用双绞线或者屏蔽线作为电源补偿电线。将屏蔽层连接到接地位，它会降低由感应效应引起的输出纹波。

3. 在负载端连接一个 0.1 μ F 到几百 μ F 的电解电容 C。
4. 打开 POWER 开关，在“CONFIG”中设置“rtSn”为 1，退出“CONFIG”。

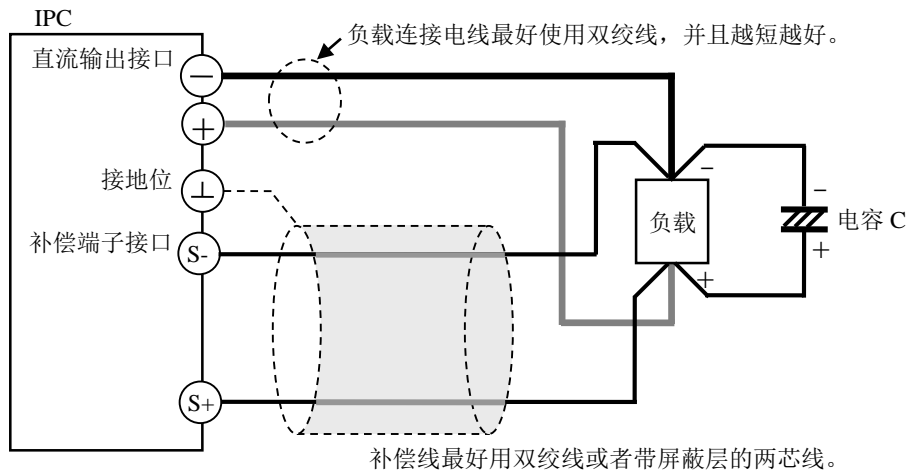


图 3-3 远端电压补偿模式

| 检查项目 | 内容 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 绝缘 | 对于远端探测线，要求其有比电源的绝缘电压更高的额定电压。详见 3.6。 当用屏蔽电缆的时候，用绝缘套管保护其裸露的部分，并且要求绝缘套管有比电源的绝缘电压更高的额定电压。 |
| 安全连接 | 如果探测电线变松，经过负载的电压会不稳定，并且可能使负载端的电压过高。为了有效连接请使用压接端子。 |
| 机械开关 | 如果使用机械开关来控制电源到负载的通断，请用独立的开关来通断探测线，并对负载电缆和远端探测线的同时通断。 |

| | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 额定电压 | 电源的输出电压受到最大电压的限制（额定输出电压的 103%）。如果负载电缆上的压降比较大，并且电源的输出大于额定电压的 103%，那么负载端的额定加载电压将不能被满足。这种情况，用有更大横截面积的电线来减少压降。保证电源的输出电压小于额定电压的 103%。 |
| 感应屏蔽 | 用双绞线或者屏蔽线做电压探测线。将屏蔽层连接到输出正极。 用绝缘套管保护其裸露的部分，并且要求绝缘套管有比电源的绝缘电压更高的额定电压。 |
| 电解电容的可承载电压 | 所用的电容需要能够承受电源额定输出电压的 120%。 |
| 探测电线的长度 | 如果压降探测线的长度大于 3 米，由电线的感应和电容所引起的相位漂移将不能被忽视，会引起振荡。在这种情况下，连接的电容会防止振荡。 |
| 负载脉冲电流 | 如果负载电流突然变成脉冲形式，输出电压可能由于探测电线的感应影响而增大。这种情况下，连接的电容 C 会阻止输出的波动。 |

远端补偿功能最大补偿压降范围

请注意，由于电源输出端到负载端的连线有电阻，当这个连线电阻变大或者连线上的电流增大时，线上的压降也会增大。IPC 系列电源中不同的额定输出电压的电源有不同的最大补偿电压。当负载连线上的压降超过这个最大补偿压降的范围时，请使用电阻更小的负载电缆。

| 额定电压 V | 远端补偿最大电压值 V |
|-----------|----------------|
| 30 | 2 |
| 36 | 2 |
| 80 | 4 |
| 108 | 5 |
| 160 | 5 |
| 300 | 5 |

**警告！**

可能产生电击，可能导致伤害甚至死亡。请使用有比电源额定输出电压更高的承载电压的电缆。

可能烧毁负载。如果探测电线变松，加载在负载的电压会不稳定，并且可能使负载端的电压过高。为了有效连接请使用压接端子。

停止使用远端电压补偿

当完成远端补偿功能后，去掉电压探测线并且确保在“CONFIG”中将“rtSn”设置为0。

3.4 连接负载时的注意事项

3.4.1 如何连接多个负载

本地电压补偿模式下连接多个负载

下图描述了如何在本地电压补偿模式下连接多个负载。每个负载使用一对独立的电缆分别连接到 IPC 系列电源的输出端子正、负极上面。请注意匹配各个负载电缆的长度，使其长度保持一致并尽量短。为了降低噪声，尽量使用屏蔽线或者双绞线。在“CONFIG”中将“rtSn”设置为 0。

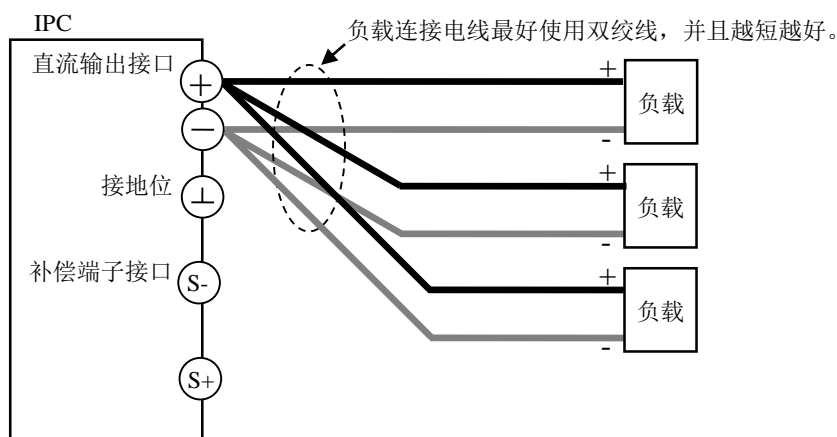


图 3-4 本地电压补偿模式下连接多个负载

远端电压补偿模式下连接多个负载

下图描述了如何在使用远端补偿功能的情况下连接多个负载。使用一对独立的电缆分别将 IPC 系列电源的输出端子正负极连接到中继端子的正负极。用导线将中继端子的正极和远端补偿功能端子的“S+”连接，同时用导线将中继端子的负极和远端补偿功能端子的“S-”连接。在“CONFIG”中将“rtSn”设置为 1。

注意

1. 匹配各个负载电缆的长度，使其长度保持一致并尽量短。
2. 为了降低噪声，尽量使用屏蔽电缆或者双绞线。在使用屏蔽电缆的时候，请将其屏蔽层与接地端子良好连接。

3. 从电源输出端子的正负极到中继端子之间的电缆要有能承受足够大的电流的能力以满足多个负载的要求。否则可能由于电缆过渡发热而导致火灾。
4. 在使用远端电压补偿模式下，请将远端补偿电缆尽量远离负载电缆以减少噪声。
5. 请将每对输出电缆独立的相互缠绕成麻花状以减少电缆的耦合阻抗。该耦合阻抗的存在会导致在输出电流变化时有高频毛刺电压加载到电源的输出端和负载端，并且导致负载端的噪声比电源输出端大。也可以在负载端的正负极间连接一个过滤高频噪声的旁路电容。

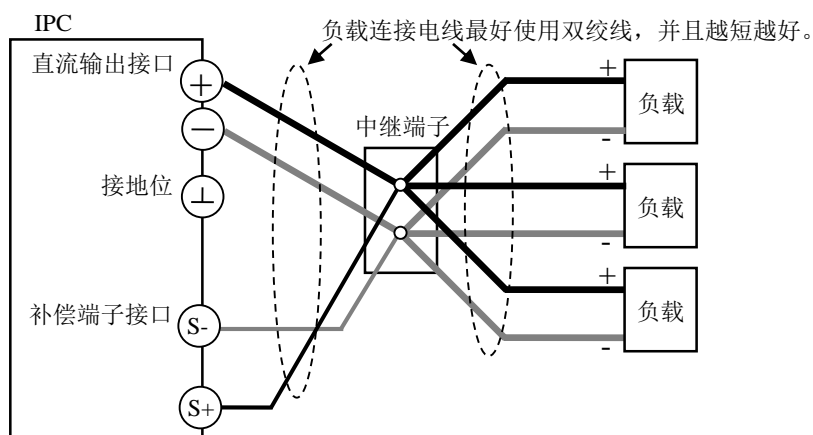


图 3-5 远端电压补偿模式下连接多个负载

3.4.2 感性负载的注意事项

感性负载会给 IPC 系列电源的输出端加载尖峰电压。这种情况下需要在电源的输出端并联一个最大反向电压和额定电流都大于电源额定输出的二极管。将二极管的阴极与电源输出端子的正极连接，将二极管的阳极与电源输出端子的负极连接。

当负载有瞬态的高电压加载到电源输出端时时，为了避免负载电流倒灌进电源，需要在电源的输出端连接一个浪涌抑制器（比如瞬态抑制二极管）。

3.4.3 负载有类似电池的储能作用

将电源连接到电池等的有储能作用的负载，可能会导致大量电流通过电源内部电路的保护二极管流入电源内部的滤波电容。这个电流可能会损坏电源或者缩短负载的使用寿命。

对于这类负载，在电源和负载之间连接一个反向电流保护二极管 D_{RP} 。如下图所示：



第四章 基本操作

主要介绍使用本电源的一些基本操作。

第四章 基本操作

4.1 基本使用流程

电源打开步骤

1. 关闭电源开关【POWER】
2. 检查电源电缆是否连接正确
3. 打开给电源供电的插线板上的电源开关
4. 打开电源开关【POWER】
5. 按一下设置按键【SET】，然后按【V/C】按键使得 LED 指示灯停留在 V 处，旋转面板上的旋钮设置电压值

输出电压设置范围可以从 0 到额定电压。

6. 再按一次【V/C】按键使得 LED 指示灯停留在 A 处，旋转面板上的旋钮设置电流值

输出电流设置范围可以从 0 到额定电流。

电源已经准备好。

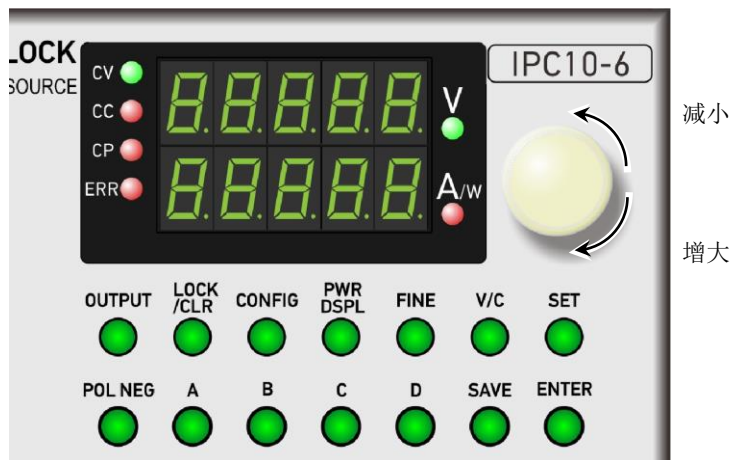


图 4-1 操作面板说明

4.2 让电源恒流输出

1. 电源连接负载，检查连接线是否有破损
2. 电源接通交流电后按下“POWER 键”，让电源正常供电
3. 按一下设置按键【SET】，然后按【V/C】按键使得 LED 指示灯停留在 V 处，顺时针旋转面板上的旋钮设置电压值到最大
4. 再按一次按【V/C】按键使得 LED 指示灯停留在 A 处，旋转面板上的旋钮设置电流到某一需要的值（如有需要可以按下【FINE】键进行精调）
5. 再按一下设置按键【SET】关闭设置，按下【OUTPUT】按键进行输出

控制面板上的恒流指示灯（CC）会亮起，指示电源工作在恒流模式。



警告！

可能产生电击。可能导致伤害甚至死亡。连接负载的时候，请关断 POWER 开关。

当负载不能承受剧烈变化的电流时

对于以下形式的负载，需要在上面的 1-3 步骤后执行 6-8 步骤。

- a. 电阻不明的负载。
 - b. 电阻变化大的负载。
 - c. 有较大电感的感性负载。
6. 再按一次按【V/C】按键使得 LED 指示灯停留在 A 处，逆时针旋转面板上的旋钮设置电流到最小值 0
 7. 再按一下设置按键【SET】关闭设置，打开【OUTPUT】开关
 8. 顺时针缓慢旋转旋钮，使得电流逐渐增大

控制面板上的恒流指示灯（CC）会亮起，指示电源工作在恒流模式。

4.3 让电源恒压输出

1. 电源连接负载，检查连接线是否有破损
2. 电源接通交流电后按下“POWER 键”，让电源正常供电
3. 按一下设置按键【SET】，然后按【V/C】按键使得 LED 指示灯停留在 A 处，顺时针旋转面板上的旋钮设置电流值到最大
4. 再按一次按【V/C】按键使得 LED 指示灯停留在 V 处，旋转面板上的旋钮设置电压到某一需要的值（如有需要可以按下【FINE】键进行精调）
5. 再按一下设置按键【SET】关闭设置，按下【OUTPUT】按键进行输出

控制面板上的恒流指示灯（CV）会亮起，指示电源工作在恒压模式。



警告！

可能产生电击。可能导致伤害甚至死亡。连接负载的时候，请关断 POWER 开关。

当负载不能承受剧烈变化的电压时

对于以下形式的负载，需要在上面的 1-3 步骤后执行 6-8 步骤。

- a. 电阻不明的负载。
 - b. 电阻变化大的负载。
 - c. 有较大电感的感性负载。
6. 再按一次按【V/C】按键使得 LED 指示灯停留在 V 处，逆时针旋转面板上的旋钮设置电流到最小值 0
 7. 再按一下设置按键【SET】关闭设置，打开【OUTPUT】开关
 8. 顺时针缓慢旋转旋钮，使得电压逐渐增大

控制面板上的恒流指示灯（CV）会亮起，指示电源工作在恒压模式。

4.4 OVP 的设定

1. 电源接通交流电后按下“POWER 键”，让电源正常供电
2. 按一下【CONFIG】按键，且按键绿灯亮起，进入菜单选项，第一排数码管显示“OVP”，第二排数码管显示当前 OVP 的数值
3. 按一下【ENTER】按键，进入参数值设置，旋转面板上的旋钮设置 OVP 值到某一需要的值
4. 然后按一下【ENTER】按键，退出参数值设置，回到参数名选择，如果需要设置其他参数，顺时针旋转旋钮，第一排数码管将依次显示“OCP”、“rECL”、“rtSn”、“bAud”、“Addr”
5. 如果不需要进行其它参数的设置，再按一下【CONFIG】按键，且按键绿灯熄灭，系统退出菜单选项

4.5 OCP 的设定

1. 电源接通交流电后按下“POWER 键”，让电源正常供电
2. 按一下【CONFIG】按键，且按键绿灯亮起，进入菜单选项，第一排数码管显示“OVP”，第二排数码管显示当前 OVP 的数值
3. 顺时针旋转面板上的旋钮，第一排数码管显示“OCP”
4. 按一下【ENTER】按键，进入参数值设置，旋转面板上的旋钮设置 OCP 值到某一需要的值
5. 然后按一下【ENTER】按键，退出参数值设置，回到参数名选择，如果需要设置其他参数，顺时针旋转旋钮，第一排数码管将依次显示“rECL”、“rtSn”、“bAud”、“Addr”
6. 如果不需要进行其它参数的设置，再按一下【CONFIG】按键，且按键绿灯熄灭，系统退出菜单选项

4.6 报警的种类和报警状态的解除

报警的种类

IPC 系列电源具有多种异常状态的报警功能。

- 过压保护（OVP）
- 过流保护（OCP）
- 温度报警

当 IPC 系列电源因为过压保护和过流保护的原因而进入报警状态的时候，电源会自动关断直流输出，并且控制面板的红色指示灯 ERR 亮起，数码管会显示“OVP Err”或者“OCP Err”。

当 IPC 系列电源因为其它原因而进入报警状态的时候，电源会自动关断直流输出，并且控制面板的红色指示灯 ERR 亮起，第一排数码管会显示“Err”，第二排数码管会显示相对应的代码。

电源报警代码定义如下：

| 显示代码 | 报警状态定义 |
|------|---------|
| 16 | 温度报警 |
| 17 | 温度报警已恢复 |

报警状态的解除

IPC 系列电源进入报警状态，电源会自动切断直流输出。要想恢复电源的直流输出，用户必须手动按一下控制面板的【LOCK/CLR】按键来解除报警状态或者直接关闭【POWER】开关。解除电源报警状态后，需要根据报警的代码指示找到相应的问题所在，解决后才能按【OUTPUT】按键进行输出。在没有解决报警问题就按了【OUTPUT】按键，电源还会进行报警状态而无法输出。

5

第五章 远程控制

本章适用于程控接口电源。主要介绍如何使用后面板的远程控制接口进行电源控制。

第五章 远程控制

5.1 远程控制接口

用户除了能够通过前面板控制 IPC 系列电源，还可以用上位机（电脑，PLC 或单片机等）通过后面板 J1、J2 连接器的 RS485 和 J3 连接器的 RS232 接口来控制电源。

后面板的远程控制接口可以执行以下操作：

1. 用远程控制接口对电源进行一系列控制（设置/查询电压和电流，打开/关闭输出等）
2. 电压和电流的程控校准



警告！

不正确的触碰控制接口会导致电击或者输出短路。当使用远程控制时，确保遵循恰当的操作步骤。

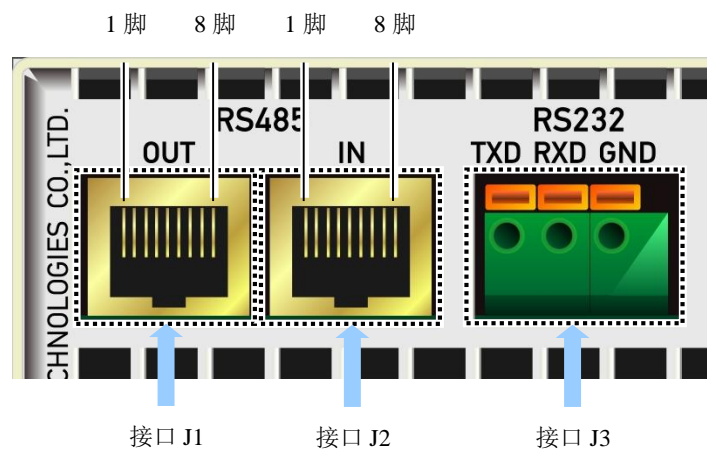


图 5-1 远程控制接口

表 5-1 远程控制接口 J1 和 J2 定义说明

| 引脚 | 标识 | 功能描述 | |
|----|-----|-------|---------------|
| J1 | 1 | RS485 | RS485 的 D-引脚。 |
| | 2 | RS485 | RS485 的 D+引脚。 |
| | 3~8 | RS485 | RS485 的信号地。 |

表 5-2 远程控制接口 J3 定义说明

| 引脚 | 标识 | 功能描述 | |
|----|----|------|---------------|
| J3 | 1 | TXD | RS232 数据发送引脚。 |
| | 2 | RXD | RS232 数据接收引脚。 |
| | 3 | GND | RS232 的信号地。 |

为了减小噪声对电源输出的影响，可以使用 3 芯屏蔽电缆或者双绞线来连接控制接口和上位机，并且让它们之间的连线尽可能的短。就算使用的是能抑制噪声的特殊电缆，如果连接线过长，它也会很容易受到噪声的干扰从而影响 IPC 电源的正常工作。

如果用户使用屏蔽电缆，可以将屏蔽层连接到输出端子的负极。

5.2 RS232 接口使用流程

电源打开步骤

1. 关闭电源开关【POWER】
2. 用屏蔽电缆连接 RS232 接口到上位机
3. 打开电源开关【POWER】，按 1 次【CONFIG】按键，按键绿灯亮起，进入系统参数设置
4. 顺时针旋转旋钮，直到数码管显示“bAud”，按 1 次【ENTER】按键，然后旋转旋钮为串口通信设置一个波特率
5. 再按 1 次【CONFIG】按键，按键绿灯熄灭，退出系统参数设置
6. 在上位机将控制软件的波特率设置和电源的一致，即可通过软件指令控制电源



注意！

远程控制的时候，电源 CONFIG 中的波特率与上位机的波特率必须保持一致。

RS-232 接口与上位机的连接

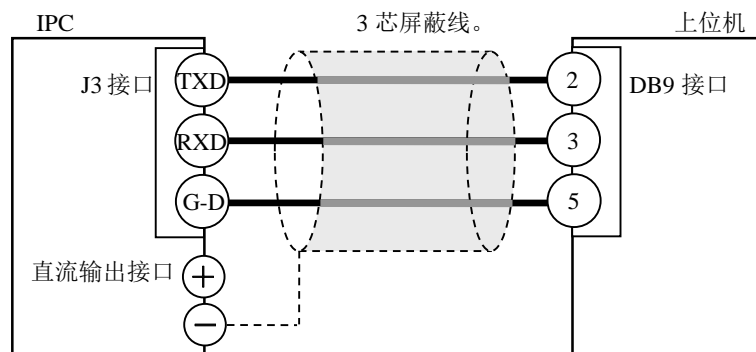


图 5-2 RS232 接口连接示意图

RS-232 接口通信参数设置

在电脑的控制软件中，需要对 RS232 的通信参数进行初始化设置。


| 通信项目 | 参数设置 |
|------|---------------------------------------|
| 波特率 | 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 56000 |
| 奇偶校验 | 无 |
| 数据位 | 8 |
| 停止位 | 1 |
| 结束符 | 换行（16 进制 0X0A） |

5.3 RS485 接口使用流程

电源打开步骤

1. 关闭电源开关【POWER】
2. 用屏蔽电缆连接 RS485 接口到上位机
3. 打开电源开关【POWER】，按 1 次【CONFIG】按键，按键绿灯亮起，进入系统参数设置
4. 顺时针旋转旋钮，直到数码管显示“bAud”，按 1 次【ENTER】按键，然后旋转旋钮为串口通信设置一个波特率
5. 再按 1 次【ENTER】按键，退出波特率设置
6. 顺时针旋转旋钮，直到数码管显示“Addr”，按 1 次【ENTER】按键，然后旋转旋钮为 RS485 通信设置一个地址
7. 再按 1 次【ENTER】按键，退出波特率设置

8. 再按 1 次【CONFIG】按键，按键绿灯熄灭，退出系统参数设置
9. 在上位机将控制软件的波特率和地址设置和电源的一致，即可通过软件指令控制电源

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | <p>注意！</p> <p>远程控制的时候，电源 CONFIG 中的波特率、地址与上位机的波特率、地址必须保持一致。</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

RS-485 接口与上位机的连接

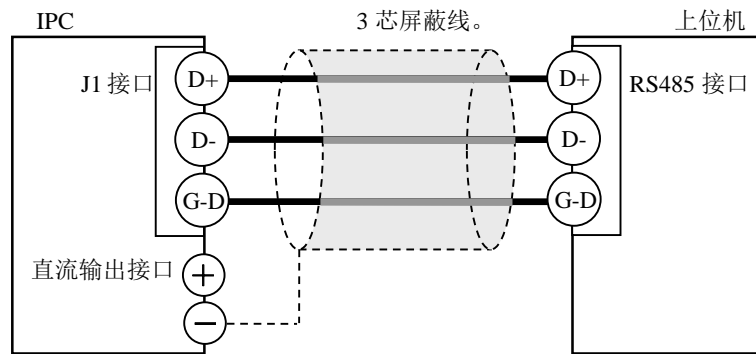


图 5-3 RS485 连接示意图

RS-485 接口通信参数设置

在电脑的控制软件中，需要对 RS485 的通信参数进行初始化设置。

| 通信项目 | 参数设置 |
|------|---------------------------------------|
| 波特率 | 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 56000 |
| 奇偶校验 | 无 |
| 数据位 | 8 |
| 停止位 | 1 |
| 结束符 | 换行（16 进制 0X0A） |
| 地址范围 | 1~254 |

5.4 RS232/RS485 接口程控使用说明

IPC 指令呈分级结构(树系统),并分为不同的子系统,每个子系统以不同的根关键字区分,关键字之间用冒号“:”分隔。指令关键字后面跟随参数,关键字和参数之间用“空格”分开。指令的结束符为 “\n”(即 16 进制中的 0x0a)。

5.4.1 指令说明

符号说明

1、问号 ?

如果指令结尾有问号,表示此指令为查询指令,执行后仪器会返回相应的应答信息。

2、竖线 |

竖线用来分隔多个参数,使用指令时,每次只能选其中一个参数。

3、逗号 ,

对于多个输入参数的指令,参数间由逗号隔开每个参数。

4、尖括号 < >

尖括号表示其中内容为必填的指令参数,不可省略。

指令大小写

IPC 指令对于大小字母不敏感,您在输入指令即可采用大写形式,也可以采用小写形式。

单位说明

对于指令集中的数值型参数,均采用国际标准单位,即电流参数的单位为安培 (A),电压参数的单位为伏特 (V)。

指令集说明

IPC 系列电源支持 RS232 与 RS485 两种程控接口,其指令集的区别是 RS485 的指令增加了地址系统,以 ADDR xxx 开头,xxx 表示受控电源的地址,该地址可取值范围 1~254。IPC 的本地地址,由电源前面板 CONFIG 菜单内“Addr”选项的值来设定。

5.4.2 IPC 系列电源 RS485 接口指令系统

- 1、指令格式: ADDR xxx:*IDN?
指令功能: 查询仪器 ID。
返回值: Interlock Technologies,IPCxxxx,xxxxxxxx,xx.xx.xx
应用实例: ADDR 6:*IDN? 查询地址为 6 的电源 ID

- 2、指令格式: ADDR xxx:MEAS:CURRE?
指令功能: 查询输出端子上的电流测量值。
返回值: 如: 1.24
应用实例: ADDR 6:MEAS:CURRE? 查询地址为 6 的电源电流测量值

- 3、指令格式: ADDR xxx:MEAS:VOLT?
指令功能: 查询输出端子上的电压测量值。
返回值: 如: 8.21
应用实例: ADDR 6:MEAS:VOLT? 查询地址为 6 的电源电压测量值

- 4、指令格式: ADDR xxx:MEAS:POW?
指令功能: 查询电源的输出功率。
返回值: 如: 2.66
应用实例: ADDR 6:MEAS:POW? 查询地址为 6 的电源的输出功率

- 5、指令格式: ADDR xxx:OUTP ON|OFF
指令功能: 开启/关闭输出通道。
应用实例: ADDR 6:OUTP ON 开启地址为 6 的电源输出通道

- 6、指令格式: ADDR xxx:OUTP?
指令功能: 查询输出通道是否开启。
返回值: 1 或 0, 表示当前输出通道开启或则关闭。
应用实例: ADDR 6:OUTP? 查询地址为 6 的电源输出通道状态

- 7、指令格式: ADDR xxx:CURRE <current>|MAX|MIN
指令功能: 设置输出通道的电流值。
参数说明: 将输出通道的电流设置值为<current>。
 <current>为实数时,可取范围为 0~MAX,不同型号的电源可以设置的最大值 MAX,由使用手册的“最大电流”指标项决定。
 当参数为 MAX 时,表示设定输出通道的电流值为最大值。
 当参数为 MIN 时,表示设定输出通道的电流值为 0。
应用实例: ADDR 6:CURRE MAX 设置地址为 6 的电源输出通道的电流值为最大值
 ADDR 6:CURRE 0.12 设置地址为 6 的电源输出通道的电流值为 0.12A

8、指令格式: ADDR xxx:CURRE? [MAX|MIN]

指令功能: 查询输出通道的电流设置值。

返回值: 返回输出通道的电流设置值, 如 1.234;

选择 MAX 参数时, 返回输出通道的最大电流设置值;

选择 MIN 参数时, 返回输出通道的最小电流设置值。

应用实例: ADDR 6:CURRE? MAX 查询地址为 6 的电源输出通道的最大电流设置值

ADDR 6:CURRE? 查询地址为 6 的电源输出通道的电流设置值

9、指令格式: ADDR xxx:VOLT <voltage>|MAX|MIN

指令功能: 设置输出通道的电压值。

参数说明: 指令执行后将立刻改变输出通道的电压设置值为<voltage>。

<voltage>为实数时, 可取范围为 0~MAX, 不同型号的电源可以设置的最大值 MAX, 由使用手册的“最大电压”指标项决定。

当参数为 MAX 时, 表示设定输出通道的最大电压值。

当参数为 MIN 时, 表示设定输出通道的最小电压值, 一般为 0。

应用实例: ADDR 6:VOLT MAX 设置地址为 6 的电源输出通道的电压值为最大值

ADDR 6:VOLT 8.46 设置地址为 6 的电源输出通道的电压值为 8.46V

10、指令格式: ADDR xxx:VOLT? [MAX|MIN]

指令功能: 查询输出通道的电压设置值。

返回值: 指令执行后返回输出通道的电压设置值, 如 18.46;

选择 MAX 参数时, 返回输出通道的最大电压设置值;

选择 MIN 参数时, 返回输出通道的最小电压设置值。

应用实例: ADDR 6:VOLT? MAX 查询地址为 6 的电源输出通道的最大电压设置值

ADDR 6:VOLT? 查询地址为 6 的电源输出通道的电压设置值

11、指令格式: ADDR xxx:CURRE:PROT <current>|MAX|MIN

指令功能: 设置输出通道的过流保护值。

参数说明: 将过流保护值设置为<current>。

<current>为实数时, 可取范围为 0~MAX, 不同型号的电源可以设置的最大值 MAX, 由使用手册的“最大过流保护值”指标项决定。

当参数为 MAX 时, 表示设定的过流保护值为最大值。

当参数为 MIN 时, 表示设定的过流保护值为 0。

应用实例: ADDR 6:CURRE:PROT MAX 设置地址为 6 的电源过流保护值为最大值

ADDR 6:CURRE:PROT 2.34 设置地址为 6 的电源过流保护值为 2.34A

- 12、指令格式: ADDR xxx:CURR:PROT? [MAX|MIN]
 指令功能: 查询输出通道的过流保护值。
 返回值: 返回过流保护值。
 选择 MAX 参数时, 返回输出通道的最大过流保护值;
 选择 MIN 参数时, 返回输出通道的最小过流保护值。
 应用实例: ADDR 6:CURR:PROT? MAX 查询地址为 6 的电源的最大过流保护值
 ADDR 6:CURR:PROT? 查询地址为 6 的电源的过流保护设置值
- 13、指令格式: ADDR xxx:VOLT:PROT <voltage>[MAX|MIN]
 指令功能: 设置输出通道的过压保护值。
 参数说明: 将过压保护值设置为<voltage>。
 <voltage>为实数时, 可取范围为 0~MAX, 不同型号的电源可以设置的最大值 MAX, 由使用手册的“最大过压保护值”指标项决定。
 当参数为 MAX 时, 表示设定的过压保护值为最大值。
 当参数为 MIN 时, 表示设定的过压保护值为 0。
 应用实例: ADDR 6:VOLT:PROT MAX 设置地址为 6 的电源过压保护值为最大值
 ADDR 6:VOLT:PROT 18.42 设置地址为 6 的电源过压保护值为 18.42V
- 14、指令格式: ADDR xxx:VOLT:PROT? [MAX|MIN]
 指令功能: 查询输出通道的过压保护值。
 返回值: 返回过压保护值。
 选择 MAX 参数时, 返回输出通道的最大过压保护值;
 选择 MIN 参数时, 返回输出通道的最小过压保护值。
 应用实例: ADDR 6:VOLT:PROT? MAX 查询地址为 6 的电源最大过压保护值
 ADDR 6:VOLT:PROT? 查询地址为 6 的电源过压保护设置值
- 15、指令格式: ADDR xxx:OUTP:PROT:CLE
 指令功能: 清除输出通道的报警触发状态。
 应用实例: ADDR 6:OUTP:PROT:CLEAR 清除地址为 6 的电源的报警触发状态
- 16、指令格式: ADDR xxx:OUTP:POL POS|NEG
 指令功能: 设置电源的输出极性, POS 为正、NEG 为负。
 应用实例: ADDR 6:OUTP:POL NEG 设置地址为 6 的电源为负极性输出
- 17、指令格式: ADDR xxx:OUTP:POL?
 指令功能: 查询电源的输出极性。
 返回值: 1 或 0,1 表示正、0 表示负。
 应用实例: ADDR 6:OUTP:POL? 查询地址为 6 的电源的输出极性

- 18、指令格式：ADDR xxx:MEM:SAVE A|B|C|D|1|2|3|4
 ADDR xxx:MEM:STOR A|B|C|D|1|2|3|4
 指令功能：将当前的电流、电压值存储于指定位置，一共有 A、B、C、D，4 个存储位置，也可以用 1、2、3、4 来指示。
 应用实例：ADDR 6:MEM:SAVE B 将设置地址为 6 的电流、电压值存储于位置 B
- 19、指令格式：ADDR xxx:MEM:REC A|B|C|D|1|2|3|4
 指令功能：将指定位置的电流、电压值调出，一共有 A、B、C、D，4 个存储位置，也可以用 1、2、3、4 来指示。
 应用实例：ADDR 6:MEM:REC C 将设置地址为 6 的电源电流、电压值设置为位置 C 内的参数值。
- 20、指令格式：ADDR xxx:MEM:ACT ON|OFF
 指令功能：设置调出存储参数时的电源输出状态。设置为 ON 时，电源输出将保持不变；设置为 OFF 时，电源输出将关闭。
 应用实例：ADDR 6:MEM:ACT OFF 设置地址为 6 的电源调出存储参数时，电源的输出状态为关闭。
- 21、指令格式：ADDR xxx:MEM:ACT?
 指令功能：查询调出存储参数时的电源输出状态。
 返回值：1 或 0；1 表示调出时电源输出将保持不变；0 表示调出时电源输出将关闭。
 应用实例：ADDR 6:MEM:ACT? 查询地址为 6 的电源调出存储参数时，电源的输出状态。
- 22、指令格式：ADDR xxx:STAT:OPER?
 指令功能：查询电源状态。
 返回值：返回 2 个字节的电源状态值 data1、data2，
 第 1 个字节 data1 表示电源的状态，第 2 个字 data2 节表示电源的报警信息。
 应用实例：ADDR 6:STAT:OPER? 查询地址为 6 的电源状态

电源状态值 data1 定义如下：

| 十进制值 | 定义 |
|------|--------------------|
| 0 | 电源处于 OUTPUT OFF 状态 |
| 1 | 电源处于恒压状态 (CV) |
| 2 | 电源处于恒压状态 (CC) |
| 4 | 电源处于报警状态 (ERROR) |

电源报警信息 data2 定义如下：

| 十进制值 | 定义 |
|------|-----------|
| 1 | OVP 过压报警 |
| 2 | OCP 过流报警 |
| 16 | 电源温度报警 |
| 17 | 电源温度报警已恢复 |

- 23、指令格式：ADDR xxx:CAL:STAT ON|OFF
指令功能：开启/关闭校准模式
应用实例：ADDR 6:CAL:STAT ON 开启地址为 6 的电源的校准模式
- 24、指令格式：ADDR xxx:CAL:STAT?
指令功能：查询校准模式的状态
返回值： 1|0，表示校准模式开启或则关闭。
应用实例：ADDR 6:CAL:STAT? 查询地址为 6 的电源的校准模式
- 25、指令格式：ADDR xxx:CAL:CURREN
指令功能：对电源的电流进行校准
应用实例：ADDR 6:CAL:CURREN 设置地址为 6 的电源为电流校准
- 26、指令格式：ADDR xxx:CAL:VOLT
指令功能：对电源的电压进行校准
应用实例：ADDR 6:CAL:VOLT 设置地址为 6 的电源为电压校准
- 27、指令格式：ADDR xxx:CAL:LEV P1|P2
指令功能：指定校准点，P1 为第一个校准点，P2 为第二个校准点
应用实例：ADDR 6:CAL:LEV P1 设置地址为 6 的电源的第一个校准点
- 28、指令格式：ADDR xxx:CAL:DATA <value>
指令功能：输入校准值<value>
应用实例：ADDR 6:CAL:DATA 12.36 设置地址为 6 的电源的校准值为 12.36
- 29、指令格式：ADDR xxx:CAL:SAVE
指令功能：保存校准系数
应用实例：ADDR 6:CAL:SAVE 保存地址为 6 的电源的校准系数

**注意!**

在对电源发送指令时，应在指令的最后加上结束符” \n”（即 16 进制的 0x0a）。

关联指令

在使用下列指令前必须先调用 ADDR xxx:CAL:STAT ON，开启校准模式，否则电源将不响应下列指令：

```
ADDR xxx:CAL:CURREN
ADDR xxx:CAL:VOLTAGE
ADDR xxx:CAL:DATA <value>
ADDR xxx:CAL:LEV P1|P2
ADDR xxx:CAL:SAVE
```

5.4.3 IPC 系列电源 RS232 接口指令系统**1、指令格式：*IDN?**

指令功能：查询仪器 ID。

返回值： Interlock Technologies,IPCxxxx,xxxxxxxx,xx.xx.xx

应用实例： *IDN? 查询电源 ID

2、指令格式：MEAS:CURREN?

指令功能：查询输出端子上的电流测量值。

返回值： 如： 1.24

应用实例： MEAS:CURREN? 查询电源电流测量值

3、指令格式：MEAS:VOLT?

指令功能：查询输出端子上的电压测量值。

返回值： 如： 8.21

应用实例： MEAS:VOLT? 查询电源电压测量值

4、指令格式：MEAS:POWER?

指令功能：查询电源的输出功率。

返回值： 如： 2.66

应用实例： MEAS:POWER? 查询电源的输出功率

5、指令格式: **OUTP ON|OFF**

指令功能: 开启/关闭输出通道。

应用实例: **OUTP ON** 开启电源输出通道

6、指令格式: **OUTP?**

指令功能: 查询输出通道是否开启。

返回值: 1 或 0, 表示当前输出通道开启或则关闭。

应用实例: **OUTP?** 查询电源输出通道状态

7、指令格式: **CURR <current>|MAX|MIN**

指令功能: 设置输出通道的电流值。

参数说明: 将输出通道的电流设置值为<current>。

<current>为实数时, 可取范围为 0~MAX, 不同型号的电源可以设置的最大值 MAX, 由使用手册的“最大电流”指标项决定。

当参数为 MAX 时, 表示设定输出通道的电流值为最大值。

当参数为 MIN 时, 表示设定输出通道的电流值为 0。

应用实例: **CURR MAX** 设置电源输出通道的电流值为最大值

CURR 0.12 设置电源输出通道的电流值为 0.12A

8、指令格式: **CURR? [MAX|MIN]**

指令功能: 查询输出通道的电流设置值。

返回值: 返回输出通道的电流设置值, 如 1.234;

选择 MAX 参数时, 返回输出通道的最大电流设置值;

选择 MIN 参数时, 返回输出通道的最小电流设置值。

应用实例: **CURR? MAX** 查询电源输出通道的最大电流设置值

CURR? 查询电源输出通道的电流设置值

9、指令格式: **VOLT <voltage>|MAX|MIN**

指令功能: 设置输出通道的电压值。

参数说明: 指令执行后将立刻改变输出通道的电压设置值为<voltage>。

<voltage>为实数时, 可取范围为 0~MAX, 不同型号的电源可以设置的最大值 MAX, 由使用手册的“最大电压”指标项决定。

当参数为 MAX 时, 表示设定输出通道的最大电压值。

当参数为 MIN 时, 表示设定输出通道的最小电压值, 一般为 0。

应用实例: **VOLT MAX** 设置电源输出通道的电压值为最大值

VOLT 8.46 设置电源输出通道的电压值为 8.46V

10、指令格式: VOLT? [MAX|MIN]

指令功能: 查询输出通道的电压设置值。

返回值: 指令执行后返回输出通道的电压设置值, 如 18.46;
选择 MAX 参数时, 返回输出通道的最大电压设置值;
选择 MIN 参数时, 返回输出通道的最小电压设置值。

应用实例: VOLT? MAX 查询电源输出通道的最大电压设置值
VOLT? 查询电源输出通道的电压设置值

11、指令格式: CURR:PROT <current>|MAX|MIN

指令功能: 设置输出通道的过流保护值。

参数说明: 将过流保护值设置为<current>。

<current>为实数时, 可取范围为 0~MAX, 不同型号的电源可以设置的最大值 MAX, 由使用手册的“最大过流保护值”指标项决定。

当参数为 MAX 时, 表示设定的过流保护值为最大值。

当参数为 MIN 时, 表示设定的过流保护值为 0。

应用实例: CURR:PROT MAX 设置过流保护值为最大值
CURR:PROT 2.34 设置过流保护值为 2.34A

12、指令格式: CURR:PROT? [MAX|MIN]

指令功能: 查询输出通道的过流保护值。

返回值: 返回过流保护值。
选择 MAX 参数时, 返回输出通道的最大过流保护值;
选择 MIN 参数时, 返回输出通道的最小过流保护值。

应用实例: CURR:PROT? MAX 查询输出通道的最大过流保护值
CURR:PROT? 查询输出通道的过流保护设置值

13、指令格式: VOLT:PROT <voltage>|MAX|MIN

指令功能: 设置输出通道的过压保护值。

参数说明: 将过压保护值设置为<voltage>。

<voltage>为实数时, 可取范围为 0~MAX, 不同型号的电源可以设置的最大值 MAX, 由使用手册的“最大过压保护值”指标项决定。

当参数为 MAX 时, 表示设定的过压保护值为最大值。

当参数为 MIN 时, 表示设定的过压保护值为 0。

应用实例: VOLT:PROT MAX 设置过压保护值为最大值
VOLT:PROT 18.42 设置过压保护值为 18.42V

- 14、指令格式: VOLT:PROT? [MAX|MIN]
 指令功能: 查询输出通道的过压保护值。
 返回值: 返回过压保护值。
 选择 MAX 参数时, 返回输出通道的最大过压保护值;
 选择 MIN 参数时, 返回输出通道的最小过压保护值。
 应用实例: VOLT:PROT? MAX 查询输出通道的最大过压保护值
 VOLT:PROT? 查询输出通道的过压保护设置值
- 15、指令格式: OUTP:PROT:CLE
 指令功能: 清除输出通道的报警触发状态。
 应用实例: OUTP:PROT:CLEAR 清除电源的报警触发状态
- 16、指令格式: OUTP:POL POS|NEG
 指令功能: 设置电源的输出极性, POS 为正、NEG 为负。
 应用实例: OUTP:POL NEG 设置电源为负极性输出
- 17、指令格式: OUTP:POL?
 指令功能: 查询电源的输出极性。
 返回值: 1 或 0,1 表示正、0 表示负。
 应用实例: OUTP:POL? 查询电源的输出极性
- 18、指令格式: MEM:SAVE A|B|C|D|1|2|3|4
 MEM:STOR A|B|C|D|1|2|3|4
 指令功能: 将当前的电流、电压值存储于指定位置, 一共有 A、B、C、D, 4 个存储位置, 也可以用 1、2、3、4 来指示。
 应用实例: MEM:SAVE B 将当前的电流、电压值存储于位置 B
- 19、指令格式: MEM:REC A|B|C|D|1|2|3|4
 指令功能: 将指定位置的电流、电压值调出, 一共有 A、B、C、D, 4 个存储位置, 也可以用 1、2、3、4 来指示。
 应用实例: MEM:REC C 将电源的电流、电压值设置为位置 C 内的参数值。
- 20、指令格式: MEM:ACT ON|OFF
 指令功能: 设置调出存储参数时的电源输出状态。设置为 ON 时, 电源输出将保持不变;
 设置为 OFF 时, 电源输出将关闭。
 应用实例: MEM:ACT OFF 调出存储参数时, 设置电源的输出状态为关闭。

21、指令格式：MEM:ACT?

指令功能：查询调出存储参数时的电源输出状态。

返回值：1 或 0；1 表示调出时电源输出将保持不变；0 表示调出时电源输出将关闭。

应用实例：MEM:ACT? 查询调出存储参数时，电源的输出状态。

22、指令格式：STAT:OPER?

指令功能：查询电源状态。

返回值：返回 2 个字节的电源状态值 data1、data2，

第 1 个字节 data1 表示电源的状态，第 2 个字 data2 节表示电源的报警信息。

应用实例：STAT:OPER? 查询电源状态

电源状态值 data1 定义如下：

| 十进制值 | 定义 |
|------|--------------------|
| 0 | 电源处于 OUTPUT OFF 状态 |
| 1 | 电源处于恒压状态 (CV) |
| 2 | 电源处于恒压状态 (CC) |
| 4 | 电源处于报警状态 (ERROR) |

电源报警信息 data2 定义如下：

| 十进制值 | 定义 |
|------|----------|
| 1 | OVP 过压报警 |
| 2 | OCP 过流报警 |
| 16 | 温度报警 |
| 17 | 温度报警已恢复 |

23、指令格式：CAL:STAT ON|OFF

指令功能：开启/关闭校准模式

应用实例：CAL:STAT ON 开启电源的校准模式

24、指令格式：CAL:STAT?

指令功能：查询校准模式的状态

返回值：1|0，表示校准模式开启或则关闭。

应用实例：CAL:STAT? 查询电源的校准模式

- 25、指令格式: CAL:CURR
指令功能: 对电源的电流进行校准
应用实例: CAL:CURR 设置电源为电流校准
- 26、指令格式: CAL:VOLT
指令功能: 对电源的电压进行校准
应用实例: CAL:VOLT 设置电源为电压校准
- 27、指令格式: CAL:LEV P1|P2
指令功能: 指定校准点, P1 为第一个校准点, P2 为第二个校准点
应用实例: CAL:LEV P1 设置电源的第一个校准点
- 28、指令格式: CAL:DATA <value>
指令功能: 输入校准值<value>
应用实例: CAL:DATA 12.36 设置电源的校准值为 12.36
- 29、指令格式: CAL:SAVE
指令功能: 保存校准系数
应用实例: CAL:SAVE 保存电源的校准系数

**注意!**

在对电源发送指令时, 应在指令的最后加上结束符” \n” (即 16 进制的 0x0a)。

关联指令

在使用下列指令前必须先调用 CAL:STAT ON, 开启校准模式, 否则电源将不响应下列指令:

CAL:CURR
CAL:VOLT
CAL:DATA <value>
CAL:LEV P1|P2
CAL:SAVE

5.5 电压和电流的程控校准

电源在出厂前已经校准完好。但是经过长时间使用之后，电源仍然需要校准。

具体的校准步骤如下所示。

5.5.1 需要的测试设备

为了调节，需要如下设备：

直流电压表：精度大于 0.02%。

采样电阻：精度大于 0.1%。

5.5.2 环境

在以下环境中进行校准。

环境温度：23 °C ±5°C

环境湿度：80%RH 或更低

为了降低由内部漂移引起的错误，在校准之前热机 30 分钟。另外，对直流电压表和采样电阻也要按照说明书规定的要求预热。

5.5.3 校准步骤

校准包括：电压校准和电流校准。

电压的校准步骤

1. 关断交流输入
2. 将电压表连接到输出端
3. 打开电源开关，热机 30 分钟

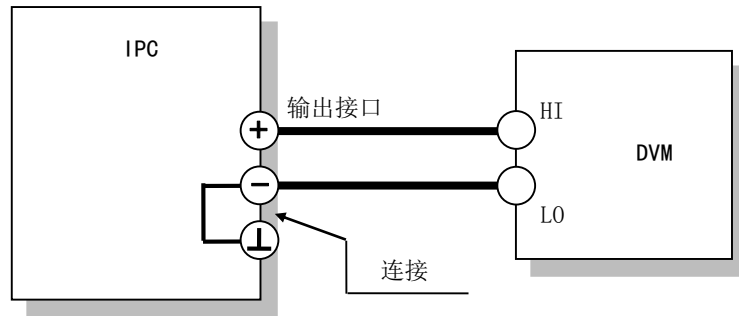


图 5-4 电压校准连接

4. 进入校准模式

OUTP ON

CAL:STAT ON

对于 RS485 接口指令为

ADDR xxx:OUTP ON

ADDR xxx:CAL:STAT ON

5. 选择电压校准

CAL:VOLT

对于 RS485 接口指令为

ADDR xxx:CAL:VOLT

6. 校准电压第一点

CAL:LEV P1

对于 RS485 接口指令为

ADDR xxx:CAL:LEV P1

7. 输入数字万用表上的电压测量值<data>

CAL:DATA <data>

对于 RS485 接口指令为

ADDR xxx:CAL:DATA <data>

8. 校准电压第二点

CAL:LEV P2

对于 RS485 接口指令为

ADDR xxx:CAL:LEV P2

9. 输入数字万用表上的电压测量值<data>

CAL:DATA <data>

对于 RS485 接口指令为

ADDR xxx:CAL:DATA <data>

10. 保存校准数据

CAL:SAVE

对于 RS485 接口指令为

ADDR xxx:CAL:SAVE

11. 退出校准模式

CAL:STAT OFF

对于 RS485 接口指令为

ADDR xxx:CAL:STAT OFF

电流的校准步骤



注意!

电流校准在电源恒流模式下进行，必须根据电源的额定电压和额定电流选择合适的负载大小。

1. 关断交流输入
2. 用短接线将远端补偿电压探测端子和电源的输出端子连接
3. 用短接线将输出负极和机壳连接
4. 将电压表连接到输出端
5. 打开电源开关，热机 30 分钟

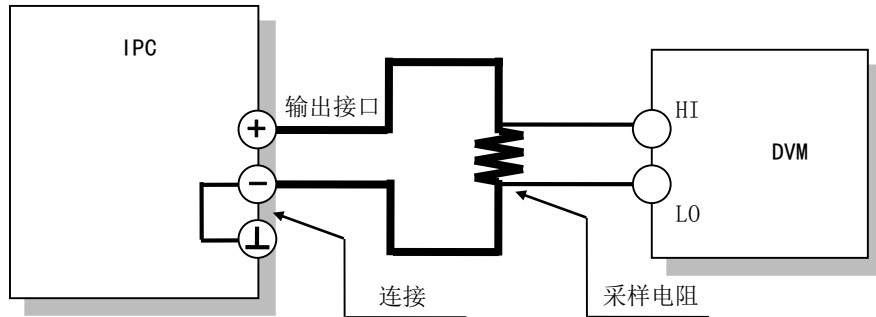


图 5-5 电流校准连接

6. 进入校准模式

OUTP ON

CAL:STAT ON

对于 RS485 接口指令为

ADDR xxx:OUTP ON

ADDR xxx:CAL:STAT ON

7. 选择电流校准

CAL:CURR

对于 RS485 接口指令为

ADDR xxx:CAL:CURR

8. 校准电流第一点

CAL:LEV P1

对于 RS485 接口指令为

ADDR xxx:CAL:LEV P1

9. 由数字万用表上的电压测量值和分流电阻阻值，计算回路中的电流<data>，并输入

CAL:DATA <data>

对于 RS485 接口指令为

ADDR xxx:CAL:DATA <data>

10. 校准电流第二点

CAL:LEV P2

对于 RS485 接口指令为

ADDR xxx:CAL:LEV P2

11. 由数字万用表上的电压测量值和分流电阻阻值，计算回路中的电流<data>，并输入

CAL:DATA <data>

对于 RS485 接口指令为

ADDR xxx:CAL:DATA <data>

12. 保存校准数据

CAL:SAVE

对于 RS485 接口指令为

ADDR xxx:CAL:SAVE

13. 退出校准模式

CAL:STAT OFF

对于 RS485 接口指令为

ADDR xxx:CAL:STAT OFF



注意！

在校准过程中，如果不使用 CAL:SAVE 指令保存当前校准数据，在退出校准模式后将恢复为前一次的校准数据，当前校准数据将被丢失。



第六章 参数

主要介绍电源的电气与机械参数。

第六章 参数

6.1 IPC 系列性能参数

除非特殊说明，电源的性能参数都是在以下条件下进行测试。

- 负载为纯电阻
- 电源输出接口的负极与机壳相连
- 至少热机 30 分钟以上

所有参数只是作为使用电源时候的参考值，并不作为电源性能的保证。

| IPC 系列 | IPC5-12 | IPC10-6 | IPC20-3 | IPC30-2 | IPC48-1.25 | IPC60-1 | IPC100-0.6 | IPC200-0.3 | IPC300-0.2 |
|------------|-----------------------------|---------|---------|---------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 直流输出 | | | | | | | | | |
| 额定电压 (V) | 5 | 10 | 20 | 30 | 48 | 60 | 100 | 200 | 300 |
| 最大电压 (V) | 5.15 | 10.3 | 20.6 | 30.9 | 49.44 | 61.8 | 103 | 206 | 309 |
| 电压变化范围 (V) | 0~5 | 0~10 | 0~20 | 0~30 | 0~48 | 0~60 | 0~100 | 0~200 | 0~300 |
| 额定电流 (A) | 12 | 6 | 3 | 2 | 1.25 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 |
| 最大电流 (A) | 12.36 | 6.18 | 3.09 | 2.06 | 1.2875 | 1.03 | 0.618 | 0.309 | 0.206 |
| 电流变化范围 (A) | 0~12 | 0~6 | 0~3 | 0~2 | 0~1.25 | 0~1 | 0~0.6 | 0~0.3 | 0~0.2 |
| 交流输入 | | | | | | | | | |
| 标称额定输入 | 220 VAC ± 10%, 50/60 Hz, 1Φ | | | | | | | | |

| IPC 系列 | IPC5-12 | IPC10-6 | IPC20-3 | IPC30-2 | IPC48-1.25 | IPC60-1 | IPC100-0.6 | IPC200-0.3 | IPC300-0.2 | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------|---------|------------|------------|------------|--|
| 额定电压特性 | | | | | | | | | | |
| 纹波 (mV) (5Hz~1MHz, RMS) | 0.5 | | | | | | 1 | 2 | 3 | |
| 电源效应 ^{注释 1-3} (mV) | 0.005% + 1 | | | | | | 0.005%+2 | 0.005%+3 | 0.005%+5 | |
| 负载效应 ^{注释 1-3} (mV) | 0.005% +5 | 0.005% + 4 | 0.005% +3 | | 0.005%+2 | | | | | |
| 瞬态响应时间 ^{注释 5} (μs) | 50 | | | | | | | | | |
| 温度系数 (ppm/°C) | 50 | | | | | | | | | |
| 额定电流特性 | | | | | | | | | | |
| 纹波 (mA) (5Hz~1MHz, RMS) | 3 | 2 | 1 | 0.5 | | | | | | |
| 电源效应 ^{注释 1-3} (mA) | 0.5 | | | | | | | | | |
| 负载效应 ^{注释 1-3} (mA) | 0.5 | | | | | | | | | |
| 温度系数 | 300 | | | | | | | | | |
| 编程接口 | | | | | | | | | | |
| RS232 接口. (选配) | 波特率: 2400 bps , 4800 bps , 9600 bps , 19200 bps , 38400 bps , 56000 bps, 115200 bps | | | | | | | | | |
| | 数据长度: 8 bits, 停止位: 1 bit, 奇偶校验位: 无 | | | | | | | | | |
| RS485 接口 (选配) | 波特率: 2400 bps , 4800 bps , 9600 bps , 19200 bps , 38400 bps , 56000 bps, 115200 bps | | | | | | | | | |
| | 数据长度: 8 bits, 停止位: 1 bit, 奇偶校验位: 无 | | | | | | | | | |
| | 地址范围: 1~254 | | | | | | | | | |
| 保护功能 | | | | | | | | | | |
| 过温保护启动 (°C) | 95, 启动后关断 OUTPUT 输出, 前面板显示 Err 警告并蜂鸣报警 | | | | | | | | | |
| OVP 值 (V) | 5.5 | 11 | 22 | 33 | 52.8 | 66 | 110 | 220 | 330 | |
| OCP 值 (A) | 13.2 | 6.6 | 3.3 | 2.2 | 1.375 | 1.1 | 0.66 | 0.33 | 0.22 | |
| OVP/OCP 触发脉冲宽度 (ms) | 50, 触发后关断 OUTPUT 输出, 前面板显示 Err 警告并蜂鸣报警 | | | | | | | | | |
| 风扇故障 | 触发后关断 OUTPUT 输出, 前面板显示 Err 警告并蜂鸣报警 | | | | | | | | | |
| 短路保护 | 电源内部设计了短路保护电路 | | | | | | | | | |
| 工作环境温度和湿度 | 0~40 °C / 10%~90% RH | | | | | | | | | |
| 储藏温度和湿度 | -10~60 °C / 低于 90% RH | | | | | | | | | |
| 冷却系统 | 风扇强制制冷 | | | | | | | | | |
| 输出极性 | 正极或者负极都可以接地 | | | | | | | | | |
| 绝缘电压 (V) | ± 500 | | | | | | | | | |

| IPC 系列 | IPC5-12 | IPC10-6 | IPC20-3 | IPC30-2 | IPC48-1.25 | IPC60-1 | IPC100-0.6 | IPC200-0.3 | IPC300-0.2 |
|-----------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 设置和回读 (RS232 或 RS485) | | | | | | | | | |
| 输出电压设置的准确度 | ± (0.05%设置值 + 0.05%额定值) | | | | | | | | |
| 输出电压设置的分辨率 (mV) | 1 | | | | 10 | | | | |
| 输出电流设置的准确度 | ± (0.5%设置值 + 0.1%额定值) | | | | | | | | |
| 输出电流设置的分辨率 (mA) | 1 | 0.1 | | | | | | | |
| 输出电压读回的准确度 | ± (0.05%设置值 + 0.05%额定值) | | | | | | | | |
| 输出电压读回的分辨率 (mV) | 1 | | | | 10 | | | | |
| 输出电流读回的准确度 | ± (0.5%设置值 + 0.1%额定值) | | | | | | | | |
| 输出电流读回的分辨率 (mA) | 1 | 0.1 | | | | | | | |
| 前显示面板 | | | | | | | | | |
| 输出电压显示的准确度 | ± (0.05%设置值 + 0.05%额定值) | | | | | | | | |
| 输出电压显示的分辨率 (mV) | 1 | | | | 10 | | | | |
| 输出电流显示的准确度 | ± (0.5%设置值 + 0.1%额定值) | | | | | | | | |
| 输出电流显示的分辨率 (mA) | 1 | 0.1 | | | | | | | |
| 功率显示 | 按下 PWR DSPL 按键, 且按键 LED 绿色指示灯亮起 | | | | | | | | |
| 输出极性切换 | 按下 POL NEG 按键, 且按键 LED 绿色指示灯亮起 | | | | | | | | |
| 输出关闭指示 (OFF) | OUTPUT 关闭, 红色 LED 灯指示 | | | | | | | | |
| 输出开启指示 (ON) | OUTPUT 启动, 绿色 LED 灯指示 | | | | | | | | |
| 恒压指示 (CV) | CV 触发时, 绿色 LED 灯指示 | | | | | | | | |
| 恒流指示 (CC) | CC 触发时, 红色 LED 灯指示 | | | | | | | | |
| 故障指示 (ERROR) | OVP/OCP/OTP/风扇故障触发时, 红色 LED 灯指示 | | | | | | | | |
| 尺寸和重量 | | | | | | | | | |
| 尺寸 | 详见下页 IPC 系列电源尺寸图 | | | | | | | | |
| 重量 (kg) | 约 3.7 | | | | | | | | |

【注释 1】由于设置值不同会有所不同。

【注释 2】% 表示额定输出的百分比。

【注释 3】使用远端感应模式, 测量点在电源面板的 S 端子




【注释 4】digits 表示最小分辨率

【注释 5】指当输出电流变化范围在 5% 到 100%, 输出电压恢复到额定值的 ±(0.05% + 10 mV) 的时间。

6.2 外观和尺寸

IPC 系列 外观和尺寸示意图

单位：mm

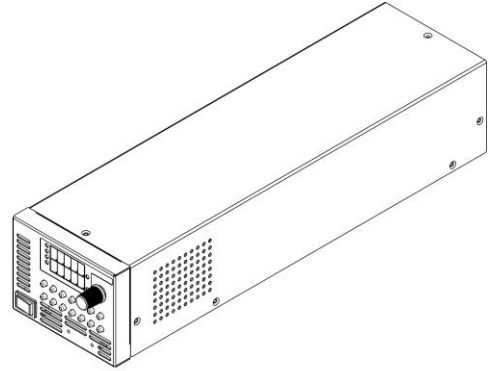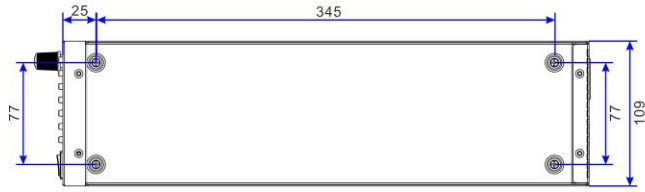

版本说明

V4.0 初稿

V4.1 修改第一版参数

V4.2 修改电压准确度的设置值，回读值，显示值： $\pm (0.05\% \text{设置值} + 0.05\% \text{额定值})$ ；电流准确度的设置值，回读值，显示值： $\pm (0.5\% \text{设置值} + 0.1\% \text{额定值})$ ；删除准确度中的(相对额定电压)和(相对额定电流)

成都英特洛克科技有限公司

四川省成都市高新西区合作路 1238 号

电话：028-8421 5528

<http://www.interlock-china.com>